

大切な人を
守るために

安心安全な除菌消臭機能水

イオン交換法 次亜塩素酸水

イオ・ジア



徹底除菌 & 強力消臭

フィンガルリンク株式会社

Life Science & System's
Finggal Link


次亜塩素酸水とは
日本で生まれた
除菌剤です

POINT

1

原因菌を元から絶つ 除菌・消臭のメカニズム

消臭芳香剤はニオイの元を芳香剤でコーティングしているだけなので、時間の経過と共に効果が薄れてしまいます。「イオン交換法次亜塩素酸水」は香りでごまかさず、ニオイの原因物質や菌を酸化分解・除去することで不活性化するため、時間が経ってもニオイが戻ることはありません。

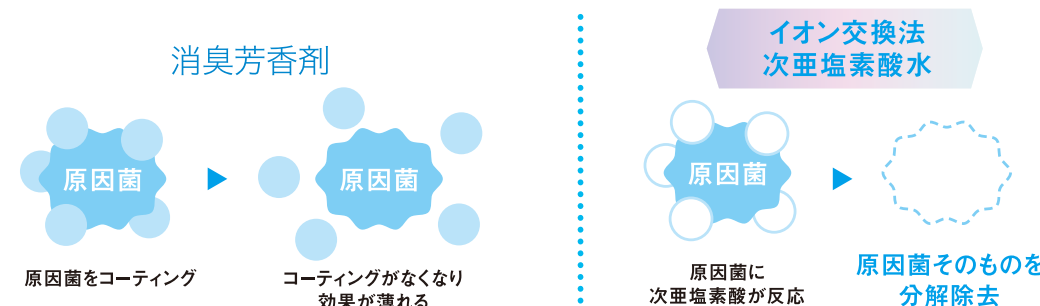


POINT

2

次亜塩素酸の持つ 除菌力・安全性 + 安定性

原料は「水」と厚生労働省が許可した食品添加物の「次亜塩素酸ナトリウム」のみを使用。独自技術でpHを調整し、次亜塩素酸が本来持つ除菌力と安全性に加え安定性を高め長期保存を可能にしました。

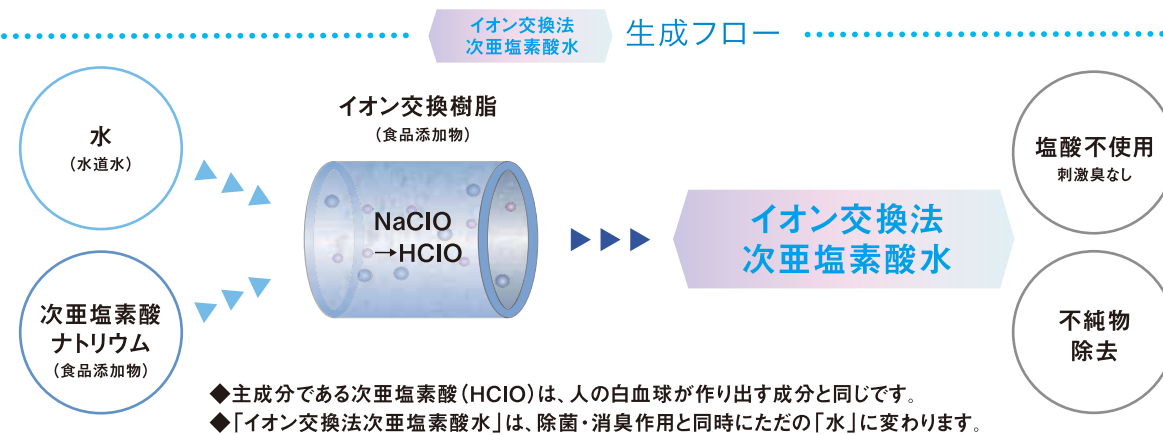

『イオン交換法』が 評価される理由

1 水道法水質基準適合


水道法の基準値(51項目)をすべてクリア。飲用水と同等の安全性を実現! 生成の過程で水道水に含まれる不純物を除去します。

2 人・動物にやさしい

皮膚刺激・眼刺激性・急性毒性の各試験のいずれにおいても600ppm以上の高濃度で安全性を確認。

次亜塩素酸ナトリウムの80倍の除菌力

独自の安定製法で抜群の信頼性

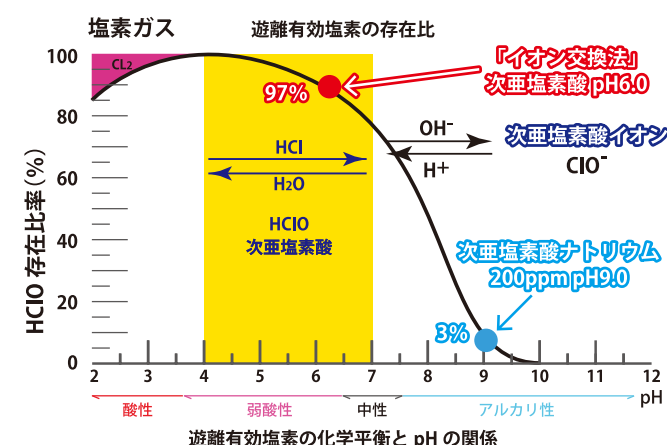

次亜塩素酸水は次亜塩素酸ナトリウム水と異なり、HClO分子の状態で菌に作用するため、除菌効果が約80倍高まるとされています。

POINT

3

イオン交換法次亜塩素酸水だからできる 徹底除菌・強力消臭

病原体を分解・不活化

主成分である次亜塩素酸は、感染症の原因となる様々な細菌やウイルスを素早く分解し不活化します。

第三者機関による評価

新型ヒトコロナウィルス(SARS-CoV-2)を本製品希釈濃度50ppmにより99.9%抑制することを確認、その他、浮遊ウィルスの除去性能評価試験や空間噴霧でのインフルエンザウィルスへの効果試験でも99.9%不活化することを確認しています。また、豚やイノシシに伝染する致死率の高いアフリカ豚熱(ASF)ウィルスを不活化することも確認されました。

ニオイの元を直接分解

除菌のメカニズムと同様にニオイの元となるアンモニアなどの雑菌やぬめりの元となるカビ、酸化した脂質やタンパク質等に作用し、分解・不活化します。

除菌スペクトル

「イオン交換法」次亜塩素酸200ppm pH5.0~6.9(微酸性次亜塩素酸水)

(芽胞菌)・枯草菌 ・セレウス菌 ・ボツリヌス菌 等

次亜塩素酸ナトリウム【水200ppm(0.02%) pH9~】

(ウイルス)・ノロ(ネコカリシ) ・インフルエンザ等(糸状菌) ・カンジタ等

アルコール(エタノール)

(一般細菌) ・黄色ブドウ球菌 ・大腸菌 ・乳酸菌 等
(食中毒菌) ・サルモネラ菌 ・緑膿菌 ・セラチア ・カンピロバクター
・腸炎ビブリオ ・リステリア ・エルシニア 等
(病原菌) ・大腸菌O-157 ・コレラ菌 ・赤痢菌 等
(真菌) ・カビ(アスペルギルス) 等

※上記の図は除菌剤一般のスペクトルを表した図になります。※特定の菌・ウイルスについての効果を保証するものではありません。



POINT

4

様々な素材・空間に! あらゆるシーンで活躍

99.9%水からできているため無色で無臭、刺激やヌメリ、ベタつきもありません。医療や介護の現場で選ばれるほどの高く幅広い除菌・消臭効果を、いつでもどこでも実感していただけます。



希釈して
噴霧

大切な人を守るために生まれた

安全で強力な微酸性次亜塩素酸

対象物に
噴射

空間に
噴射

漂白作用の心配がなく
金属腐食は
水と同じ程度

飲用試験に合格した
飲めるほど安全な
除菌消臭水

原料は水と
食品添加物
(次亜塩素酸ナトリウム)
のみ

次亜塩素酸ナトリウムは
水道水の消毒にも
使用されています

次亜塩素酸は
人間の体内でも
作られています

TERIOS

製品ラインナップ

※写真は「TERIOS3」のものになります。

300mlスプレー

●TERIOS3(300ppm/20本入り)

4Lタンク (詰め替え用)

●TERIOS80(80ppm/3本入り)
●TERIOS3(300ppm/3本入り)

20Lキューブテナー

●TERIOS80(80ppm/1箱)
●TERIOS3(300ppm/1箱)
●TERIOS6(600ppm/1箱)

⚠ 使用上の注意

※直射日光や高温多湿の場所を避け、冷暗所に保管してください。保管状況によっては濃度が下がる場合があります。
※漂白性は大幅に軽減されていますが、ごく稀に一部の材質で変色するものがございます。 ※開封後はできるだけお早めにご使用ください。
※万が一目に入った場合は、すぐに洗い流してください。 ※口に入っても人体に影響はありませんが、飲料用ではありません。
※記載事項について規定の試験を行い明記していますが、効果機能を保証するものではありません。 ※本製品は薬品ではありません。

202210

お問い合わせ・ご購入はこちら

総発売元 **フィンガルリンク株式会社**
〒111-0041
東京都台東区元浅草二丁目6番6号 東京日産台東ビル5F
TEL：03-6802-7145(代表) FAX：03-6802-7156
Mail：info@finggal-link.com
HP：http://www.finggal-link.com/

イオン交換法 次亜塩素酸水生成装置

ワンステップで設置が可能。必要なのは水と電力だけ。

- 1

コストパフォーマンス
最小限のイニシャルコストと
リードタイムで導入が可能です。
- 2

簡単な製造プロセス
・特別な知識やトレーニングは不要
・塩素濃度をワンステップでコントロール
- 3

取扱の安全性
人と環境に優しい
製造方法、製品、廃棄物

次亜塩素酸水とは
日本で生まれた
除菌剤です

HClO Waterとは・・・

日本で生まれた除菌剤。
白血球が体内の菌を除去するために生成する成分です。

アルコールと比べると・・・

生産コストや肌の影響： **より低い**

除菌時間： **より速い** 仕様用途： **より多い**

■ 水質基準 51項目

イオジアで製造した
80ppm次亜塩素酸水
は水質基準51項目の
基準値に収まりました。
水道水と同じように取り
扱いができる安心・
安全な次亜塩素酸水
です。

【注意】
※当装置は飲料水の製造をするものではありません。
※上記水質を保証するものではありません。

水質検査結果報告書

フィンガルリンク株式会社

種別

浄水用次亜塩素酸水生成装置

※本報告書は、検出日時における検出結果を示すものであり、検出結果は検出時の水質に依存します。

検出日時

2022/10/10

検出場所

東京都中央区新富町1-1-1

検出項目

臭気、色度、濁度、総硬度、カルシウム、マグネシウム、亜硝酸塩、硝酸塩、硫酸塩、塩化物、銅、鉛、鉄、マンガン、亜鉛、セレン、モリブデン、コバルト、ニッケル、クロム

検出結果

臭気: 0.00 mg/L, 色度: 0.00 mg/L, 濁度: 0.00 mg/L, 総硬度: 0.00 mg/L, カルシウム: 0.00 mg/L, マグネシウム: 0.00 mg/L, 亜硝酸塩: 0.00 mg/L, 硝酸塩: 0.00 mg/L, 硫酸塩: 0.00 mg/L, 塩化物: 0.00 mg/L, 銅: 0.00 mg/L, 鉛: 0.00 mg/L, 鉄: 0.00 mg/L, マンガン: 0.00 mg/L, 亜鉛: 0.00 mg/L, セレン: 0.00 mg/L, モリブデン: 0.00 mg/L, コバルト: 0.00 mg/L, ニッケル: 0.00 mg/L, クロム: 0.00 mg/L

検出単位

臭気: mg/L, 色度: mg/L, 濁度: mg/L, 総硬度: mg/L, カルシウム: mg/L, マグネシウム: mg/L, 亜硝酸塩: mg/L, 硝酸塩: mg/L, 硫酸塩: mg/L, 塩化物: mg/L, 銅: mg/L, 鉛: mg/L, 鉄: mg/L, マンガン: mg/L, 亜鉛: mg/L, セレン: mg/L, モリブデン: mg/L, コバルト: mg/L, ニッケル: mg/L, クロム: mg/L

検出範囲

臭気: 0.00~0.10, 色度: 0.00~0.10, 濁度: 0.00~0.10, 総硬度: 0.00~0.10, カルシウム: 0.00~0.10, マグネシウム: 0.00~0.10, 亜硝酸塩: 0.00~0.10, 硝酸塩: 0.00~0.10, 硫酸塩: 0.00~0.10, 塩化物: 0.00~0.10, 銅: 0.00~0.10, 鉛: 0.00~0.10, 鉄: 0.00~0.10, マンガン: 0.00~0.10, 亜鉛: 0.00~0.10, セレン: 0.00~0.10, モリブデン: 0.00~0.10, コバルト: 0.00~0.10, ニッケル: 0.00~0.10, クロム: 0.00~0.10

検出結果

臭気: 0.00 mg/L, 色度: 0.00 mg/L, 濁度: 0.00 mg/L, 総硬度: 0.00 mg/L, カルシウム: 0.00 mg/L, マグネシウム: 0.00 mg/L, 亜硝酸塩: 0.00 mg/L, 硝酸塩: 0.00 mg/L, 硫酸塩: 0.00 mg/L, 塩化物: 0.00 mg/L, 銅: 0.00 mg/L, 鉛: 0.00 mg/L, 鉄: 0.00 mg/L, マンガン: 0.00 mg/L, 亜鉛: 0.00 mg/L, セレン: 0.00 mg/L, モリブデン: 0.00 mg/L, コバルト: 0.00 mg/L, ニッケル: 0.00 mg/L, クロム: 0.00 mg/L

検出単位

臭気: mg/L, 色度: mg/L, 濁度: mg/L, 総硬度: mg/L, カルシウム: mg/L, マグネシウム: mg/L, 亜硝酸塩: mg/L, 硝酸塩: mg/L, 硫酸塩: mg/L, 塩化物: mg/L, 銅: mg/L, 鉛: mg/L, 鉄: mg/L, マンガン: mg/L, 亜鉛: mg/L, セレン: mg/L, モリブデン: mg/L, コバルト: mg/L, ニッケル: mg/L, クロム: mg/L

検出範囲

臭気: 0.00~0.10, 色度: 0.00~0.10, 濁度: 0.00~0.10, 総硬度: 0.00~0.10, カルシウム: 0.00~0.10, マグネシウム: 0.00~0.10, 亜硝酸塩: 0.00~0.10, 硝酸塩: 0.00~0.10, 硫酸塩: 0.00~0.10, 塩化物: 0.00~0.10, 銅: 0.00~0.10, 鉛: 0.00~0.10, 鉄: 0.00~0.10, マンガン: 0.00~0.10, 亜鉛: 0.00~0.10, セレン: 0.00~0.10, モリブデン: 0.00~0.10, コバルト: 0.00~0.10, ニッケル: 0.00~0.10, クロム: 0.00~0.10

検出結果

臭気: 0.00 mg/L, 色度: 0.00 mg/L, 濁度: 0.00 mg/L, 総硬度: 0.00 mg/L, カルシウム: 0.00 mg/L, マグネシウム: 0.00 mg/L, 亜硝酸塩: 0.00 mg/L, 硝酸塩: 0.00 mg/L, 硫酸塩: 0.00 mg/L, 塩化物: 0.00 mg/L, 銅: 0.00 mg/L, 鉛: 0.00 mg/L, 鉄: 0.00 mg/L, マンガン: 0.00 mg/L, 亜鉛: 0.00 mg/L, セレン: 0.00 mg/L, モリブデン: 0.00 mg/L, コバルト: 0.00 mg/L, ニッケル: 0.00 mg/L, クロム: 0.00 mg/L

検出単位

臭気: mg/L, 色度: mg/L, 濁度: mg/L, 総硬度: mg/L, カルシウム: mg/L, マグネシウム: mg/L, 亜硝酸塩: mg/L, 硝酸塩: mg/L, 硫酸塩: mg/L, 塩化物: mg/L, 銅: mg/L, 鉛: mg/L, 鉄: mg/L, マンガン: mg/L, 亜鉛: mg/L, セレン: mg/L, モリブデン: mg/L, コバルト: mg/L, ニッケル: mg/L, クロム: mg/L

検出範囲

臭気: 0.00~0.10, 色度: 0.00~0.10, 濁度: 0.00~0.10, 総硬度: 0.00~0.10, カルシウム: 0.00~0.10, マグネシウム: 0.00~0.10, 亜硝酸塩: 0.00~0.10, 硝酸塩: 0.00~0.10, 硫酸塩: 0.00~0.10, 塩化物: 0.00~0.10, 銅: 0.00~0.10, 鉛: 0.00~0.10, 鉄: 0.00~0.10, マンガン: 0.00~0.10, 亜鉛: 0.00~0.10, セレン: 0.00~0.10, モリブデン: 0.00~0.10, コバルト: 0.00~0.10, ニッケル: 0.00~0.10, クロム: 0.00~0.10

検出結果

臭気: 0.00 mg/L, 色度: 0.00 mg/L, 濁度: 0.00 mg/L, 総硬度: 0.00 mg/L, カルシウム: 0.00 mg/L, マグネシウム: 0.00 mg/L, 亜硝酸塩: 0.00 mg/L, 硝酸塩: 0.00 mg/L, 硫酸塩: 0.00 mg/L, 塩化物: 0.00 mg/L, 銅: 0.00 mg/L, 鉛: 0.00 mg/L, 鉄: 0.00 mg/L, マンガン: 0.00 mg/L, 亜鉛: 0.00 mg/L, セレン: 0.00 mg/L, モリブデン: 0.00 mg/L, コバルト: 0.00 mg/L, ニッケル: 0.00 mg/L, クロム: 0.00 mg/L

検出単位

臭気: mg/L, 色度: mg/L, 濁度: mg/L, 総硬度: mg/L, カルシウム: mg/L, マグネシウム: mg/L, 亜硝酸塩: mg/L, 硝酸塩: mg/L, 硫酸塩: mg/L, 塩化物: mg/L, 銅: mg/L, 鉛: mg/L, 鉄: mg/L, マンガン: mg/L, 亜鉛: mg/L, セレン: mg/L, モリブデン: mg/L, コバルト: mg/L, ニッケル: mg/L, クロム: mg/L

検出範囲

臭気: 0.00~0.10, 色度: 0.00~0.10, 濁度: 0.00~0.10, 総硬度: 0.00~0.10, カルシウム: 0.00~0.10, マグネシウム: 0.00~0.10, 亜硝酸塩: 0.00~0.10, 硝酸塩: 0.00~0.10, 硫酸塩: 0.00~0.10, 塩化物: 0.00~0.10, 銅: 0.00~0.10, 鉛: 0.00~0.10, 鉄: 0.00~0.10, マンガン: 0.00~0.10, 亜鉛: 0.00~0.10, セレン: 0.00~0.10, モリブデン: 0.00~0.10, コバルト: 0.00~0.10, ニッケル: 0.00~0.10, クロム: 0.00~0.10

検出結果

臭気: 0.00 mg/L, 色度: 0.00 mg/L, 濁度: 0.00 mg/L, 総硬度: 0.00 mg/L, カルシウム: 0.00 mg/L, マグネシウム: 0.00 mg/L, 亜硝酸塩: 0.00 mg/L, 硝酸塩: 0.00 mg/L, 硫酸塩: 0.00 mg/L, 塩化物: 0.00 mg/L, 銅: 0.00 mg/L, 鉛: 0.00 mg/L, 鉄: 0.00 mg/L, マンガン: 0.00 mg/L, 亜鉛: 0.00 mg/L, セレン: 0.00 mg/L, モリブデン: 0.00 mg/L, コバルト: 0.00 mg/L, ニッケル: 0.00 mg/L, クロム: 0.00 mg/L

検出単位

臭気: mg/L, 色度: mg/L, 濁度: mg/L, 総硬度: mg/L, カルシウム: mg/L, マグネシウム: mg/L, 亜硝酸塩: mg/L, 硝酸塩: mg/L, 硫酸塩: mg/L, 塩化物: mg/L, 銅: mg/L, 鉛: mg/L, 鉄: mg/L, マンガン: mg/L, 亜鉛: mg/L, セレン: mg/L, モリブデン: mg/L, コバルト: mg/L, ニッケル: mg/L, クロム: mg/L

検出範囲

臭気: 0.00~0.10, 色度: 0.00~0.10, 濁度: 0.00~0.10, 総硬度: 0.00~0.10, カルシウム: 0.00~0.10, マグネシウム: 0.00~0.10, 亜硝酸塩: 0.00~0.10, 硝酸塩: 0.00~0.10, 硫酸塩: 0.00~0.10, 塩化物: 0.00~0.10, 銅: 0.00~0.10, 鉛: 0.00~0.10, 鉄: 0.00~0.10, マンガン: 0.00~0.10, 亜鉛: 0.00~0.10, セレン: 0.00~0.10, モリブデン: 0.00~0.10, コバルト: 0.00~0.10, ニッケル: 0.00~0.10, クロム: 0.00~0.10

検出結果

臭気: 0.00 mg/L, 色度: 0.00 mg/L, 濁度: 0.00 mg/L, 総硬度: 0.00 mg/L, カルシウム: 0.00 mg/L, マグネシウム: 0.00 mg/L, 亜硝酸塩: 0.00 mg/L, 硝酸塩: 0.00 mg/L, 硫酸塩: 0.00 mg/L, 塩化物: 0.00 mg/L, 銅: 0.00 mg/L, 鉛: 0.00 mg/L, 鉄: 0.00 mg/L, マンガン: 0.00 mg/L, 亜鉛: 0.00 mg/L, セレン: 0.00 mg/L, モリブデン: 0.00 mg/L, コバルト: 0.00 mg/L, ニッケル: 0.00 mg/L, クロム: 0.00 mg/L

検出単位

臭気: mg/L, 色度: mg/L, 濁度: mg/L, 総硬度: mg/L, カルシウム: mg/L, マグネシウム: mg/L, 亜硝酸塩: mg/L, 硝酸塩: mg/L, 硫酸塩: mg/L, 塩化物: mg/L, 銅: mg/L, 鉛: mg/L, 鉄: mg/L, マンガン: mg/L, 亜鉛: mg/L, セレン: mg/L, モリブデン: mg/L, コバルト: mg/L, ニッケル: mg/L, クロム: mg/L

検出範囲

臭気: 0.00~0.10, 色度: 0.00~0.10, 濁度: 0.00~0.10, 総硬度: 0.00~0.10, カルシウム: 0.00~0.10, マグネシウム: 0.00~0.10, 亜硝酸塩: 0.00~0.10, 硝酸塩: 0.00~0.10, 硫酸塩: 0.00~0.10, 塩化物: 0.00~0.10, 銅: 0.00~0.10, 鉛: 0.00~0.10, 鉄: 0.00~0.10, マンガン: 0.00~0.10, 亜鉛: 0.00~0.10, セレン: 0.00~0.10, モリブデン: 0.00~0.10, コバルト: 0.00~0.10, ニッケル: 0.00~0.10, クロム: 0.00~0.10

検出結果

臭気: 0.00 mg/L, 色度: 0.00 mg/L, 濁度: 0.00 mg/L, 総硬度: 0.00 mg/L, カルシウム: 0.00 mg/L, マグネシウム: 0.00 mg/L, 亜硝酸塩: 0.00 mg/L, 硝酸塩: 0.00 mg/L, 硫酸塩: 0.00 mg/L, 塩化物: 0.00 mg/L, 銅: 0.00 mg/L, 鉛: 0.00 mg/L, 鉄: 0.00 mg/L, マンガン: 0.00 mg/L, 亜鉛: 0.00 mg/L, セレン: 0.00 mg/L, モリブデン: 0.00 mg/L, コバルト: 0.00 mg/L, ニッケル: 0.00 mg/L, クロム: 0.00 mg/L

検出単位

臭気: mg/L, 色度: mg/L, 濁度: mg/L, 総硬度: mg/L, カルシウム: mg/L, マグネシウム: mg/L, 亜硝酸塩: mg/L, 硝酸塩: mg/L, 硫酸塩: mg/L, 塩化物: mg/L, 銅: mg/L, 鉛: mg/L, 鉄: mg/L, マンガン: mg/L, 亜鉛: mg/L, セレン: mg/L, モリブデン: mg/L, コバルト: mg/L, ニッケル: mg/L, クロム: mg/L

検出範囲

臭気: 0.00~0.10, 色度: 0.00~0.10, 濁度: 0.00~0.10, 総硬度: 0.00~0.10, カルシウム: 0.00~0.10, マグネシウム: 0.00~0.10, 亜硝酸塩: 0.00~0.10, 硝酸塩: 0.00~0.10, 硫酸塩: 0.00~0.10, 塩化物: 0.00~0.10, 銅: 0.00~0.10, 鉛: 0.00~0.10, 鉄: 0.00~0.10, マンガン: 0.00~0.10, 亜鉛: 0.00~0.10, セレン: 0.00~0.10, モリブデン: 0.00~0.10, コバルト: 0.00~0.10, ニッケル: 0.00~0.10, クロム: 0.00~0.10

検出結果

臭気: 0.00 mg/L, 色度: 0.00 mg/L, 濁度: 0.00 mg/L, 総硬度: 0.00 mg/L, カルシウム: 0.00 mg/L, マグネシウム: 0.00 mg/L, 亜硝酸塩: 0.00 mg/L, 硝酸塩: 0.00 mg/L, 硫酸塩: 0.00 mg/L, 塩化物: 0.00 mg/L, 銅: 0.00 mg/L, 鉛: 0.00 mg/L, 鉄: 0.00 mg/L, マンガン: 0.00 mg/L, 亜鉛: 0.00 mg/L, セレン: 0.00 mg/L, モリブデン: 0.00 mg/L, コバルト: 0.00 mg/L, ニッケル: 0.00 mg/L, クロム: 0.00 mg/L

検出単位

臭気: mg/L, 色度: mg/L, 濁度: mg/L, 総硬度: mg/L, カルシウム: mg/L, マグネシウム: mg/L, 亜硝酸塩: mg/L, 硝酸塩: mg/L, 硫酸塩: mg/L, 塩化物: mg/L, 銅: mg/L, 鉛: mg/L, 鉄: mg/L, マンガン: mg/L, 亜鉛: mg/L, セレン: mg/L, モリブデン: mg/L, コバルト: mg/L, ニッケル: mg/L, クロム: mg/L

検出範囲

臭気: 0.00~0.10, 色度: 0.00~0.10, 濁度: 0.00~0.10, 総硬度: 0.00~0.10, カルシウム: 0.00~0.10, マグネシウム: 0.00~0.10, 亜硝酸塩: 0.00~0.10, 硝酸塩: 0.00~0.10, 硫酸塩: 0.00~0.10, 塩化物: 0.00~0.10, 銅: 0.00~0.10, 鉛: 0.00~0.10, 鉄: 0.00~0.10, マンガン: 0.00~0.10, 亜鉛: 0.00~0.10, セレン: 0.00~0.10, モリブデン: 0.00~0.10, コバルト: 0.00~0.10, ニッケル: 0.00~0.10, クロム: 0.00~0.10

検出結果

臭気: 0.00 mg/L, 色度: 0.00 mg/L, 濁度: 0.00 mg/L, 総硬度: 0.00 mg/L, カルシウム: 0.00 mg/L, マグネシウム: 0.00 mg/L, 亜硝酸塩: 0.00 mg/L, 硝酸塩: 0.00 mg/L, 硫酸塩: 0.00 mg/L, 塩化物: 0.00 mg/L, 銅: 0.00 mg/L, 鉛: 0.00 mg/L, 鉄: 0.00 mg/L, マンガン: 0.00 mg/L, 亜鉛: 0.00 mg/L, セレン: 0.00 mg/L, モリブデン: 0.00 mg/L, コバルト: 0.00 mg/L, ニッケル: 0.00 mg/L, クロム: 0.00 mg/L

検出単位

臭気: mg/L, 色度: mg/L, 濁度: mg/L, 総硬度: mg/L, カルシウム: mg/L, マグネシウム: mg/L, 亜硝酸塩: mg/L, 硝酸塩: mg/L, 硫酸塩: mg/L, 塩化物: mg/L, 銅: mg/L, 鉛: mg/L, 鉄: mg/L, マンガン: mg/L, 亜鉛: mg/L, セレン: mg/L, モリブデン: mg/L, コバルト: mg/L, ニッケル: mg/L, クロム: mg/L

検出範囲

臭気: 0.00~0.10, 色度: 0.00~0.10, 濁度: 0.00~0.10, 総硬度: 0.00~0.10, カルシウム: 0.00~0.10, マグネシウム: 0.00~0.10, 亜硝酸塩: 0.00~0.10, 硝酸塩: 0.00~0.10, 硫酸塩: 0.00~0.10, 塩化物: 0.00~0.10, 銅: 0.00~0.10, 鉛: 0.00~0.10, 鉄: 0.00~0.10, マンガン: 0.00~0.10, 亜鉛: 0.00~0.10, セレン: 0.00~0.10, モリブデン: 0.00~0.10, コバルト: 0.00~0.10, ニッケル: 0.00~0.10, クロム: 0.00~0.10

検出結果

臭気: 0.00 mg/L, 色度: 0.00 mg/L, 濁度: 0.00 mg/L, 総硬度: 0.00 mg/L, カルシウム: 0.00 mg/L, マグネシウム: 0.00 mg/L, 亜硝酸塩: 0.00 mg/L, 硝酸塩: 0.00 mg/L, 硫酸塩: 0.00 mg/L, 塩化物: 0.00 mg/L, 銅: 0.00 mg/L, 鉛: 0.00 mg/L, 鉄: 0.00 mg/L, マンガン: 0.00 mg/L, 亜鉛: 0.00 mg/L, セレン: 0.00 mg/L, モリブデン: 0.00 mg/L, コバルト: 0.00 mg/L, ニッケル: 0.00 mg/L, クロム: 0.00 mg/L

検出単位

臭気: mg/L, 色度: mg/L, 濁度: mg/L, 総硬度: mg/L, カルシウム: mg/L, マグネシウム: mg/L, 亜硝酸塩: mg/L, 硝酸塩: mg/L, 硫酸塩: mg/L, 塩化物: mg/L, 銅: mg/L, 鉛: mg/L, 鉄: mg/L, マンガン: mg/L, 亜鉛: mg/L, セレン: mg/L, モリブデン: mg/L, コバルト: mg/L, ニッケル: mg/L, クロム: mg/L

検出範囲

臭気: 0.00~0.10, 色度: 0.00~0.10, 濁度: 0.00~0.10, 総硬度: 0.00~0.10, カルシウム: 0.00~0.10, マグネシウム: 0.00~0.10, 亜硝酸塩: 0.00~0.10, 硝酸塩: 0.00~0.10, 硫酸塩: 0.00~0.10, 塩化物: 0.00~0.10, 銅: 0.00~0.10, 鉛: 0.00~0.10, 鉄: 0.00~0.10, マンガン: 0.00~0.10, 亜鉛: 0.00~0.10, セレン: 0.00~0.10, モリブデン: 0.00~0.10, コバルト: 0.00~0.10, ニッケル: 0.00~0.10, クロム: 0.00~0.10

検出結果

臭気: 0.00 mg/L, 色度: 0.00 mg/L, 濁度: 0.00 mg/L, 総硬度: 0.00 mg/L, カルシウム: 0.00 mg/L, マグネシウム: 0.00 mg/L, 亜硝酸塩: 0.00 mg/L, 硝酸塩: 0.00 mg/L, 硫酸塩: 0.00 mg/L, 塩化物: 0.00 mg/L, 銅: 0.00 mg/L, 鉛: 0.00 mg/L, 鉄: 0.00 mg/L, マンガン: 0.00 mg/L, 亜鉛: 0.00 mg/L, セレン: 0.00 mg/L, モリブデン: 0.00 mg/L, コバルト: 0.00 mg/L, ニッケル: 0.00 mg/L, クロム: 0.00 mg/L

検出単位

臭気: mg/L, 色度: mg/L, 濁度: mg/L, 総硬度: mg/L, カルシウム: mg/L, マグネシウム: mg/L, 亜硝酸塩: mg/L, 硝酸塩: mg/L, 硫酸塩: mg/L, 塩化物: mg/L, 銅: mg/L, 鉛: mg/L, 鉄: mg/L, マンガン: mg/L, 亜鉛: mg/L, セレン: mg/L, モリブデン: mg/L, コバルト: mg/L, ニッケル: mg/L, クロム: mg/L

検出範囲

臭気: 0.00~0.10, 色度: 0.00~0.10, 濁度: 0.00~0.10, 総硬度: 0.00~0.10, カルシウム: 0.00~0.10, マグネシウム: 0.00~0.10, 亜硝酸塩: 0.00~0.10, 硝酸塩: 0.00~0.10, 硫酸塩: 0.00~0.10, 塩化物: 0.00~0.10, 銅: 0.00~0.10, 鉛: 0.00~0.10, 鉄: 0.00~0.10, マンガン: 0.00~0.10, 亜鉛: 0.00~0.10, セレン: 0.00~0.10, モリブデン: 0.00~0.10, コバルト: 0.00~0.10, ニッケル: 0.00~0.10, クロム: 0.00~0.10

検出結果

臭気: 0.00 mg/L, 色度: 0.00 mg/L, 濁度: 0.00 mg/L, 総硬度: 0.00 mg/L, カルシウム: 0.00 mg/L, マグネシウム: 0.00 mg/L, 亜硝酸塩: 0.00 mg/L, 硝酸塩: 0.00 mg/L, 硫酸塩: 0.00 mg/L, 塩化物: 0.00 mg/L, 銅: 0.00 mg/L, 鉛: 0.00 mg/L, 鉄: 0.00 mg/L, マンガン: 0.00 mg/L, 亜鉛: 0.00 mg/L, セレン: 0.00 mg/L, モリブデン: 0.00 mg/L, コバルト: 0.00 mg/L, ニッケル: 0.00 mg/L, クロム: 0.00 mg/L

検出単位

臭気: mg/L, 色度: mg/L, 濁度: mg/L, 総硬度: mg/L, カルシウム: mg/L, マグネシウム: mg/L, 亜硝酸塩: mg/L, 硝酸塩: mg/L, 硫酸塩: mg/L, 塩化物: mg/L, 銅: mg/L, 鉛: mg/L, 鉄: mg/L, マンガン: mg/L, 亜鉛: mg/L, セレン: mg/L, モリブデン: mg/L, コバルト: mg/L, ニッケル: mg/L, クロム: mg/L

検出範囲

臭気: 0.00~0.10, 色度: 0.00~0.10, 濁度: 0.00~0.10, 総硬度: 0.00~0.10, カルシウム: 0.00~0.10, マグネシウム: 0.00~0.10, 亜硝酸塩: 0.00~0.10, 硝酸塩: 0.00~0.10, 硫酸塩: 0.00~0.10, 塩化物: 0.00~0.10, 銅: 0.00~0.10, 鉛: 0.00~0.10, 鉄: 0.00~0.10, マンガン: 0.00~0.10, 亜鉛: 0.00~0.10, セレン: 0.00~0.10, モリブデン: 0.00~0.10, コバルト: 0.00~0.10, ニッケル: 0.00~0.10, クロム: 0.00~0.10

※本報告書は、検出日時における検出結果を示すものであり、検出結果は検出時の水質に依存します。

検出日時

2022/10/10

検出場所

東京都中央区新富町1-1-1

検出項目

臭気、色度、濁度、総硬度、カルシウム、マグネシウム、亜硝酸塩、硝酸塩、硫酸塩、塩化物、銅、鉛、鉄、マンガン、亜鉛、セレン、モリブデン、コバルト、ニッケル、クロム

検出結果

臭気: 0.00 mg/L, 色度: 0.00 mg/L, 濁度: 0.00 mg/L, 総硬度: 0.00 mg/L, カルシウム: 0.00 mg/L, マグネシウム: 0.00 mg/L, 亜硝酸塩: 0.00 mg/L, 硝酸塩: 0.00 mg/L, 硫酸塩: 0.00 mg/L, 塩化物: 0.00 mg/L, 銅: 0.00 mg/L, 鉛: 0.00 mg/L, 鉄: 0.00 mg/L, マンガン: 0.00 mg/L, 亜鉛: 0.00 mg/L, セレン: 0.00 mg/L, モリブデン: 0.00 mg/L, コバルト: 0.00 mg/L, ニッケル: 0.00 mg/L, クロム: 0.00 mg/L

検出単位

臭気: mg/L, 色度: mg/L, 濁度: mg/L, 総硬度: mg/L, カルシウム: mg/L, マグネシウム: mg/L, 亜硝酸塩: mg/L, 硝酸塩: mg/L, 硫酸塩: mg/L, 塩化物: mg/L, 銅: mg/L, 鉛: mg/L, 鉄: mg/L, マンガン: mg/L, 亜鉛: mg/L, セレン: mg/L, モリブデン: mg/L, コバルト: mg/L, ニッケル: mg/L, クロム: mg/L

検出範囲